


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1997.11	管理番号	P008285
型式	MILLAC-511V	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

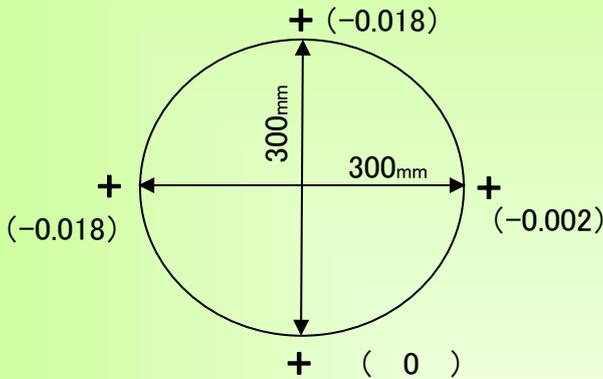

主軸振れ



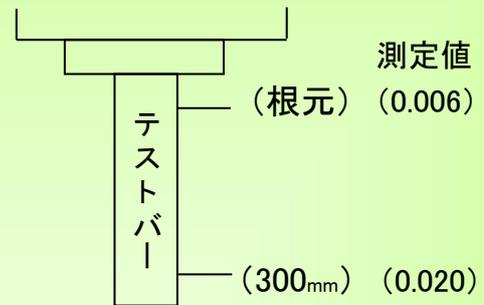


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.006)

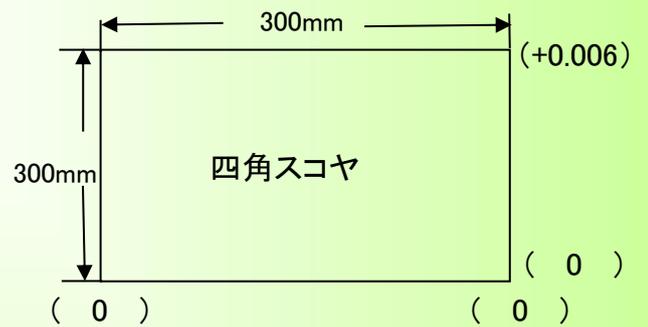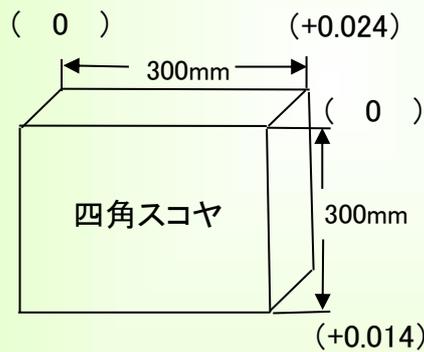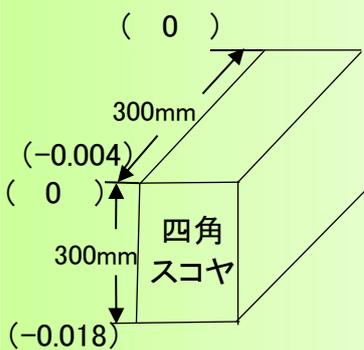

上面精度

※テーブルサイズ 1270×510

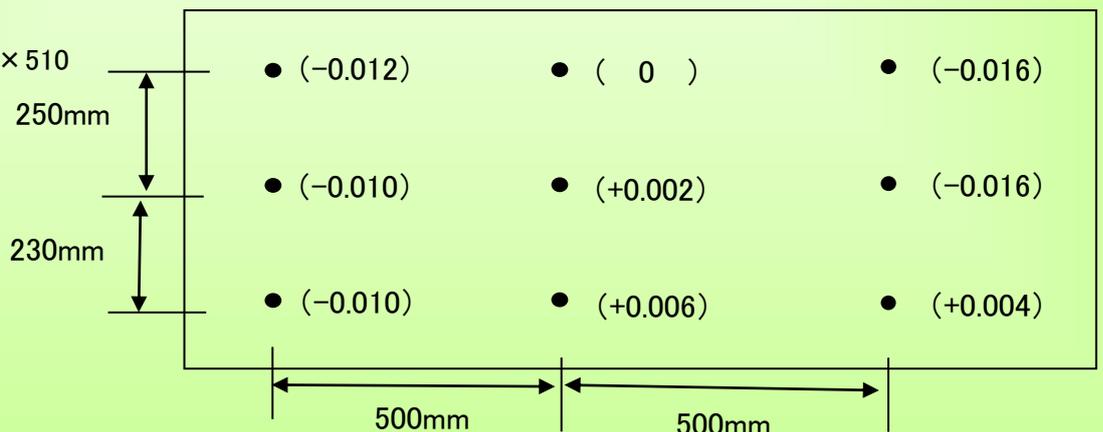

2023/8/7