


# 精度測定検査表

Examination for precision list


メーカー	森精機	年式	2010	管理番号	P008129
型式	ACCUMILL4000	測定者	武藤	アシスタント	

## 主軸振れ

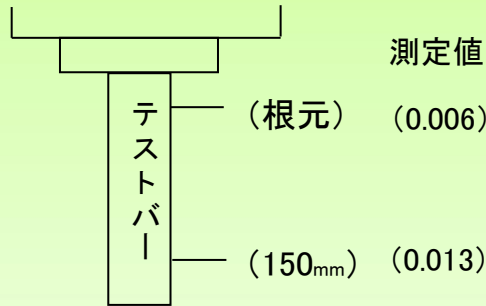


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.008)      【XZ】 測定値 (0.006)

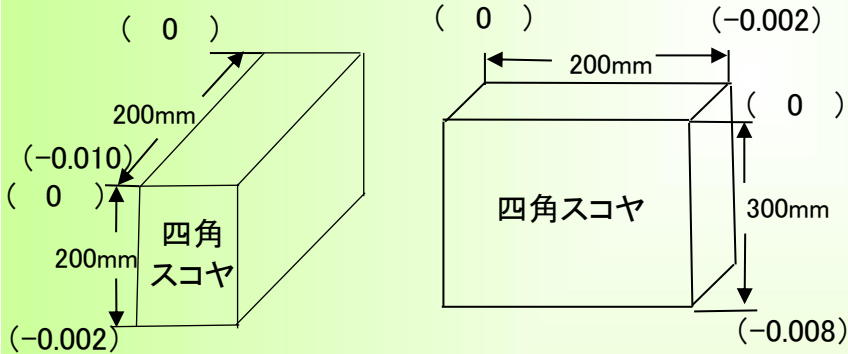

## 上面精度

インデックステーブルφ140

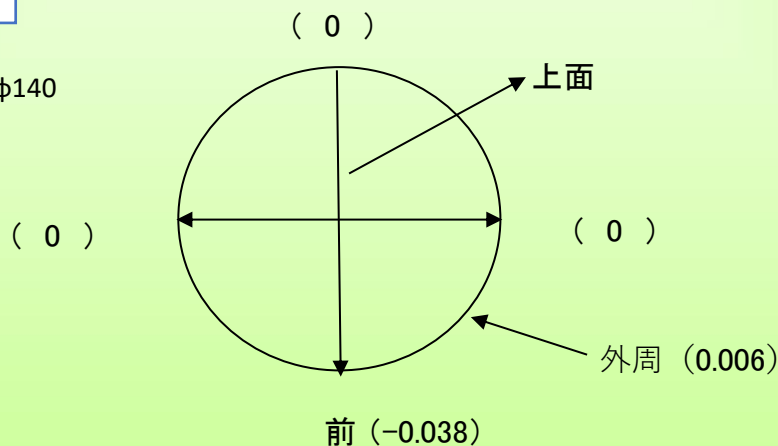

2023/7/20