


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	北村	年式	2006	管理番号	P008268
型式	Mycenter-0iF	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(200ピッチ)

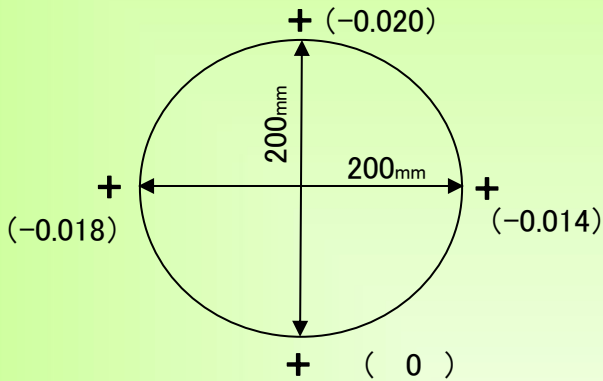

## 主軸振れ



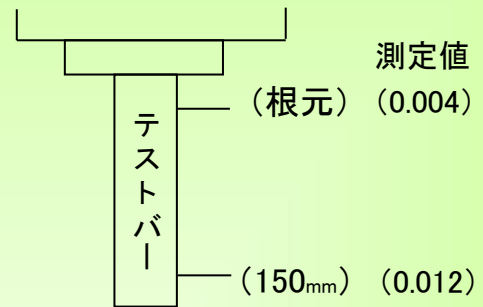


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.006)

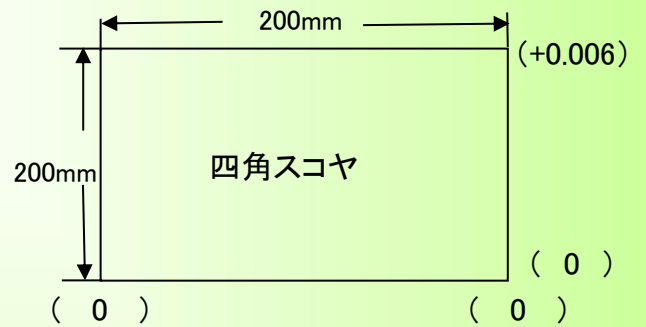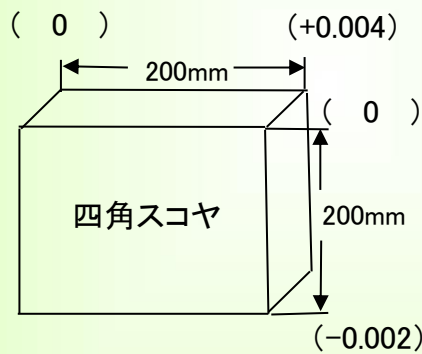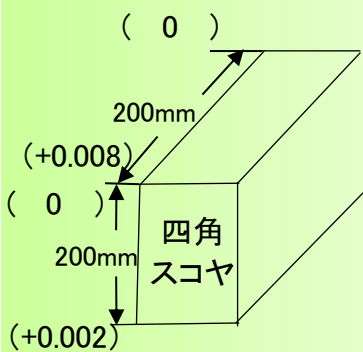

## 上面精度

※テーブルサイズ 315×610

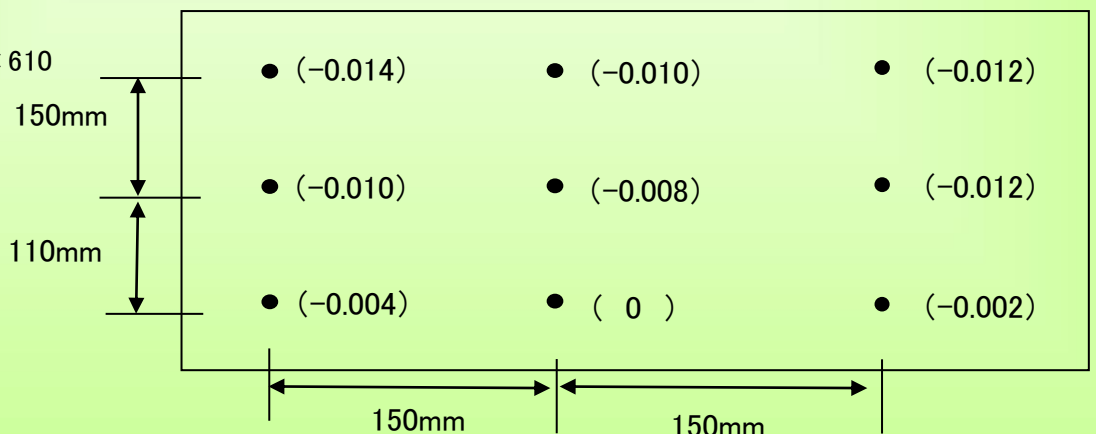

2023/11/29