


# 精度測定検査表

*Examination for precision list*


メーカー	大隈豊和	年式	2001	バーコード	P005576
型式	MLLAC-1000VH	測定者	金子	アシスタント	

## Z軸方向の平行度

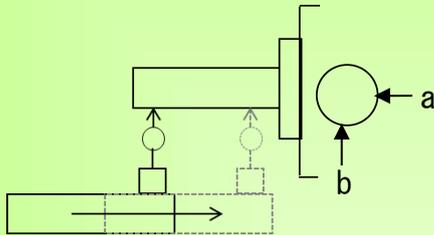


a : ( 0 ) (-0.008)  
b : ( 0 ) (+0.006)

## 振り回し(300ピッチ)

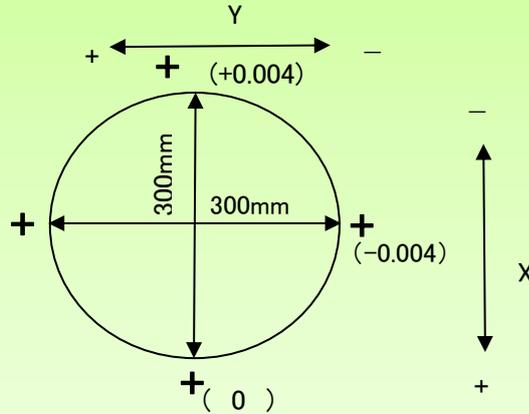

## 主軸振れ



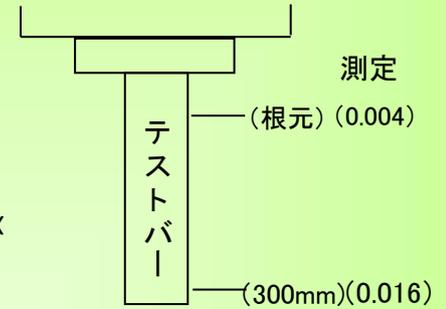


## 直角度

【XY】 測定値 ( 0.016 )

【ZY】 測定値 ( 0.002 )

【ZX】 測定値 ( 0.020 )

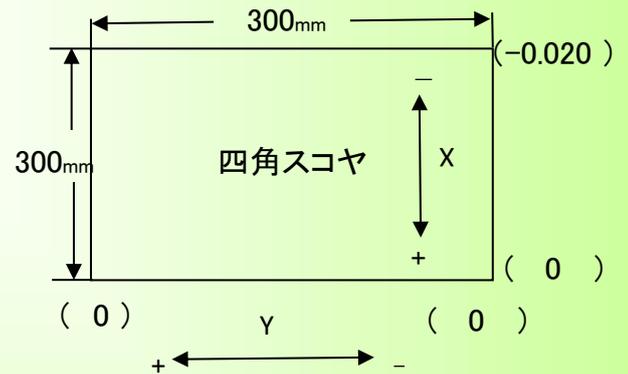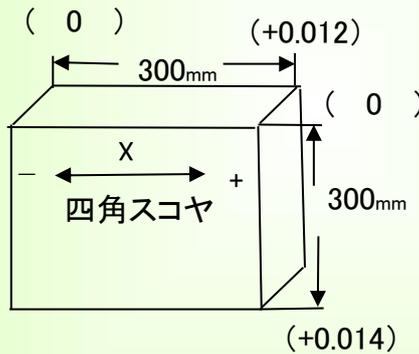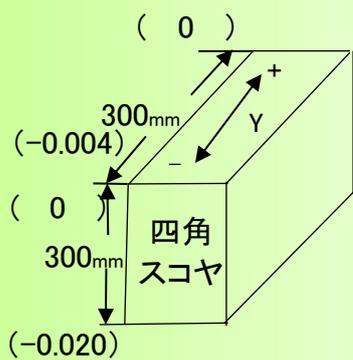

## 上面精度

