


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	大隈豊和	年式	2003年製	管理番号	H016030
型式	MILLAC-1052V	測定者	平野	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

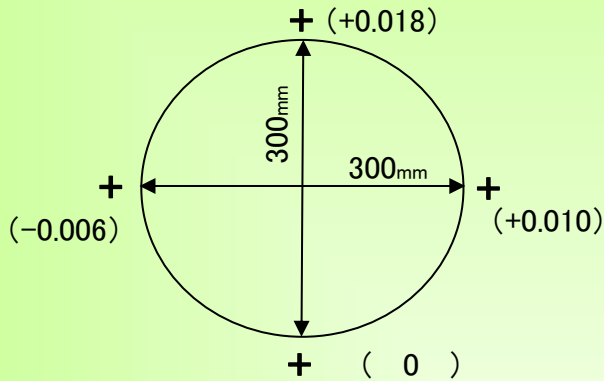

## 主軸振れ



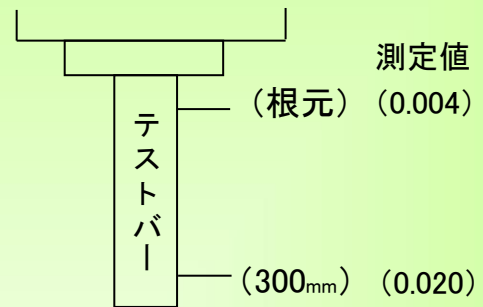


## 直角度

【YZ】 測定値 (0.020)


【XZ】 測定値 (0.014)

【XY】 測定値 (0.012)

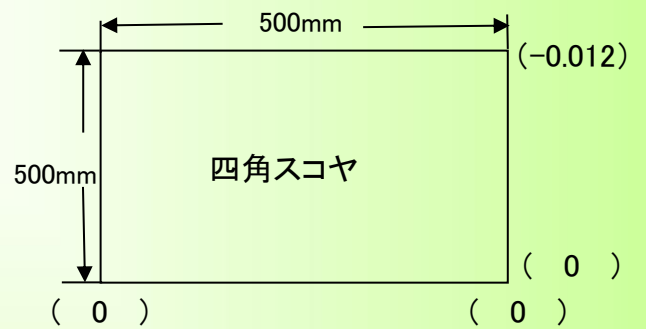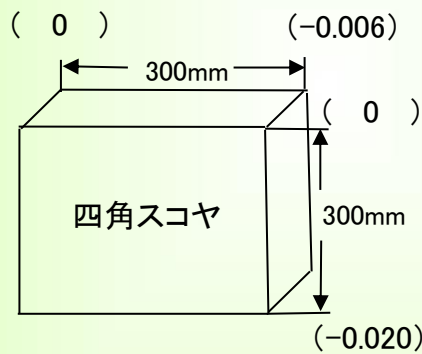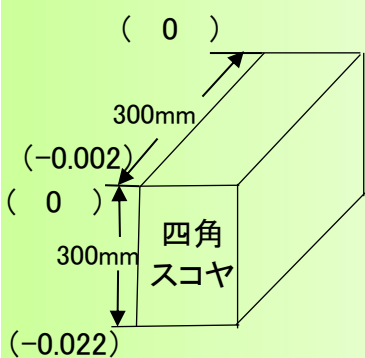

## 上面精度

※テーブルサイズ 2200×1050

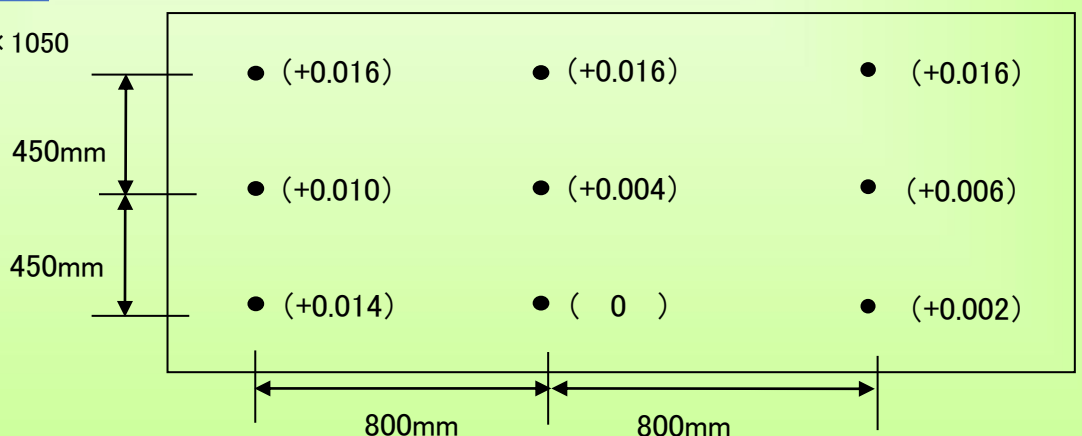

2021/6/25