


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2003年	管理番号	P008347
型式	NV5000A/40	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

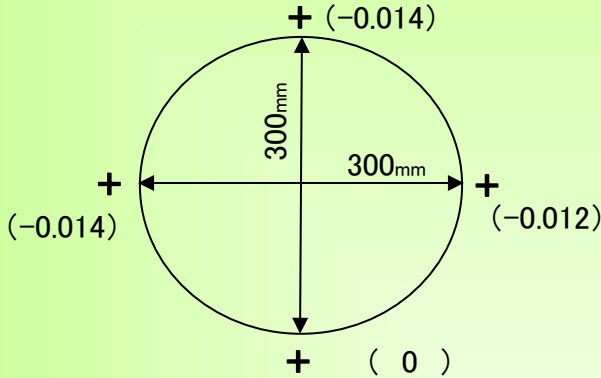

主軸振れ



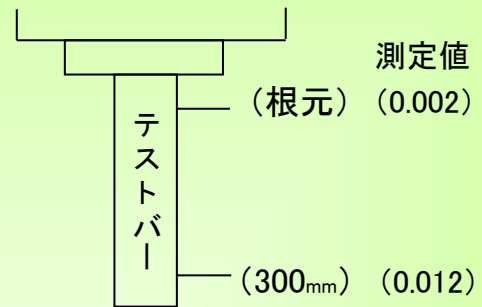


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.004)


【XY】測定値 (0.010)

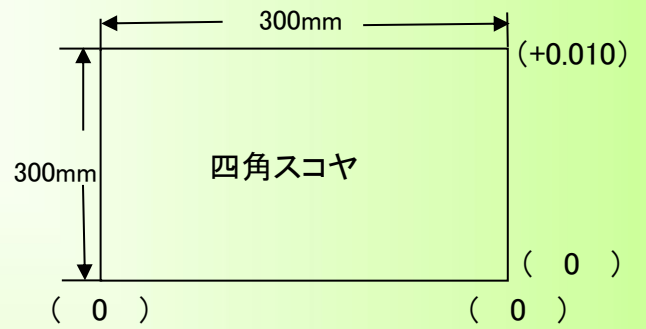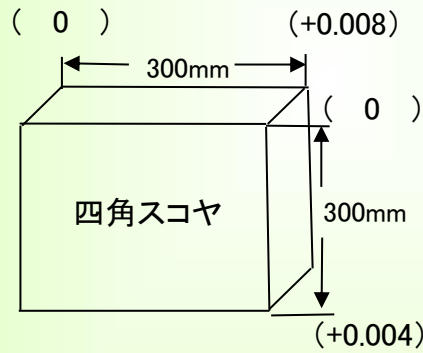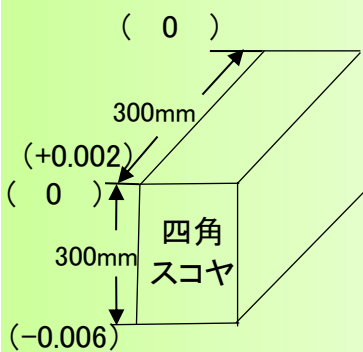

上面精度

※テーブルサイズ 950×480

- No.1
- ◆ No.2

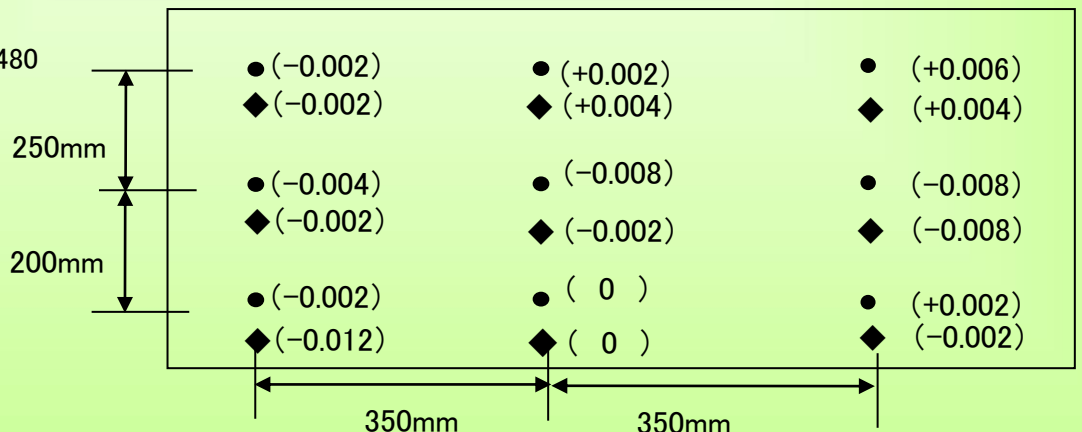

2023/11/6