


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2015	管理番号	P008331
型式	MILLAC-561V II	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

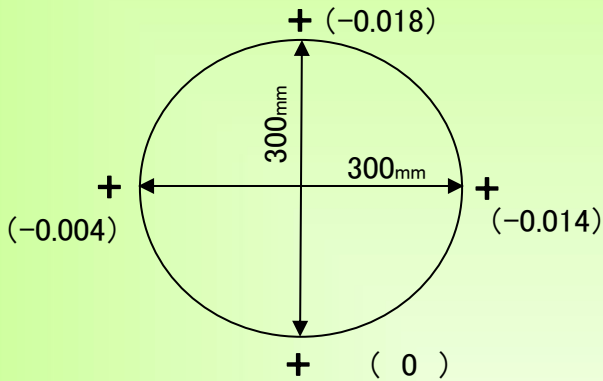

主軸振れ



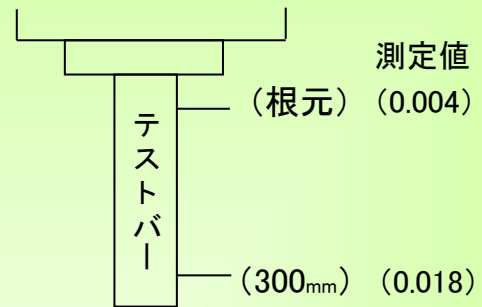


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.008)

【XY】 測定値 (0.004)

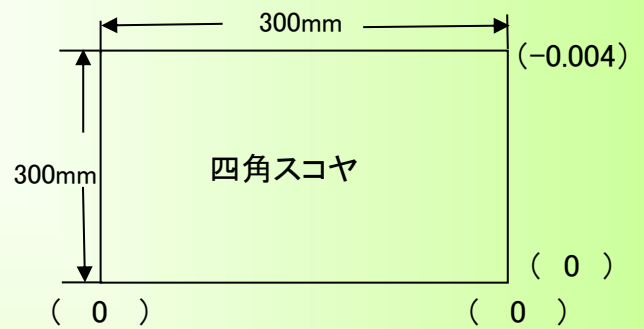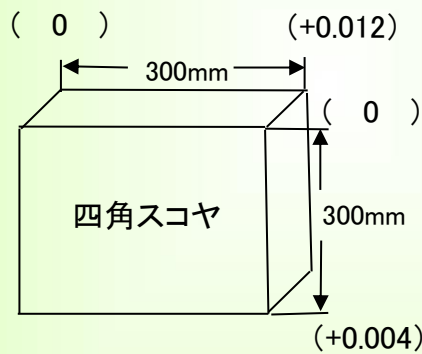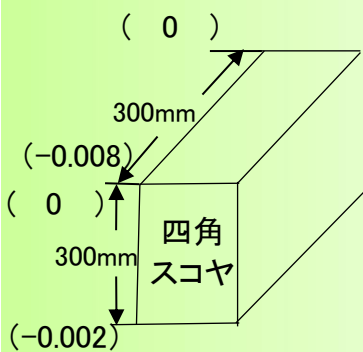

上面精度

※テーブルサイズ 1350 × 560

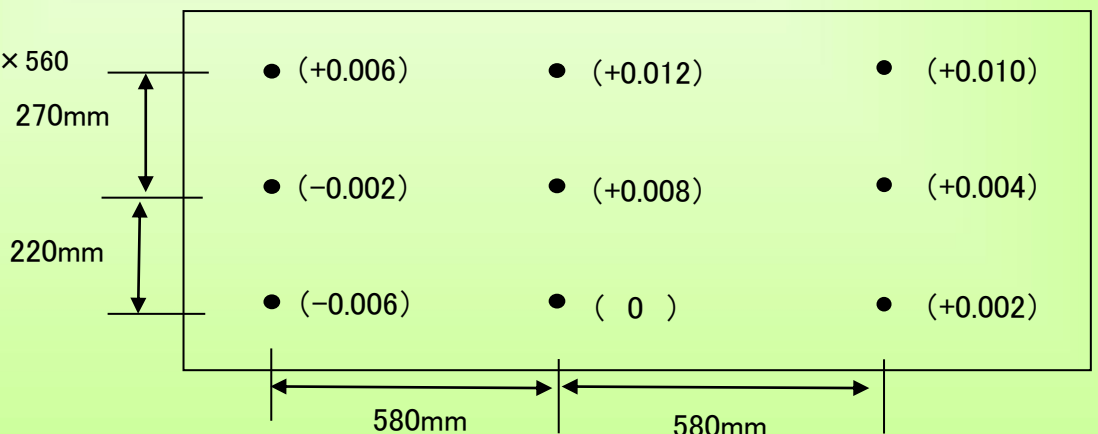

2023/8/28