


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	北村	年式	2017	管理番号	P008290
型式	Mycenter-4XiD	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

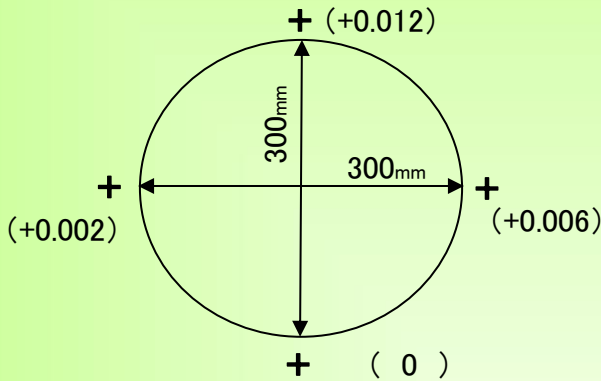

主軸振れ



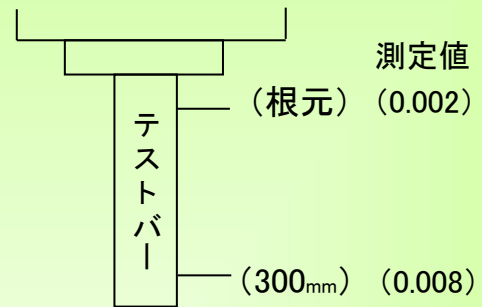


直角度

【YZ】測定値 (0.018)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.008)

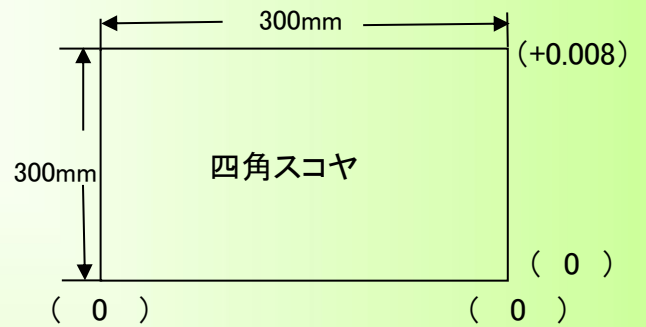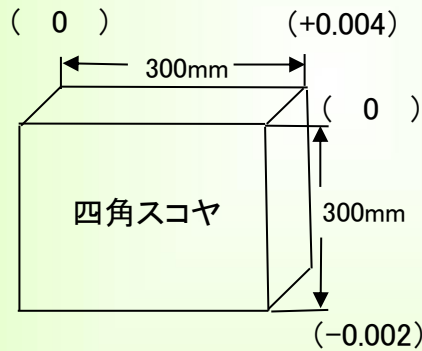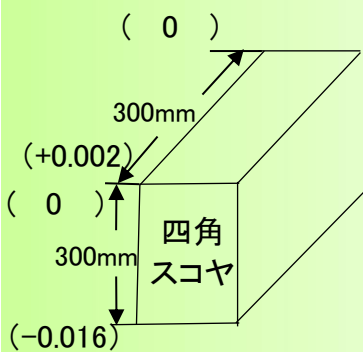

上面精度

※テーブルサイズ 1120×500

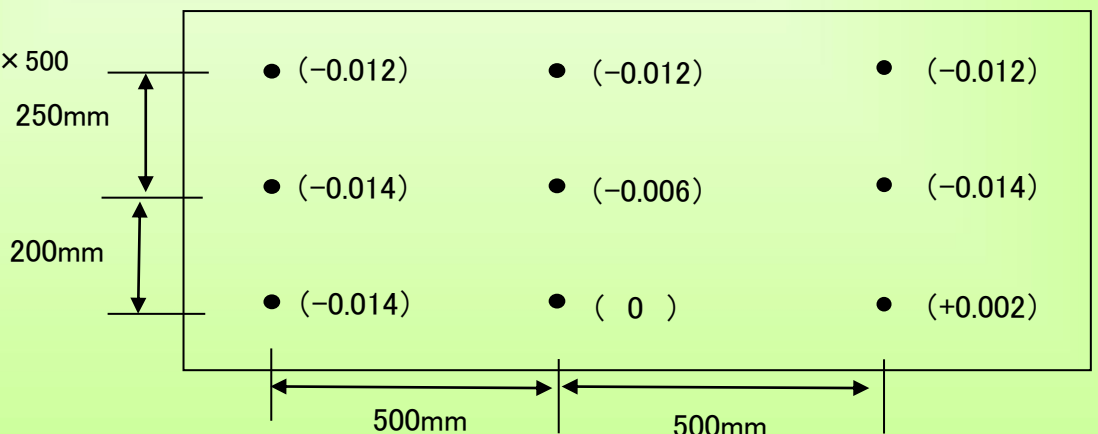

2023/8/24