


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	三井精機	年式	1999年製	管理番号	P007379
型式	HU40A	測定者	奥澤	アシスタント	

Z軸方向の平行度

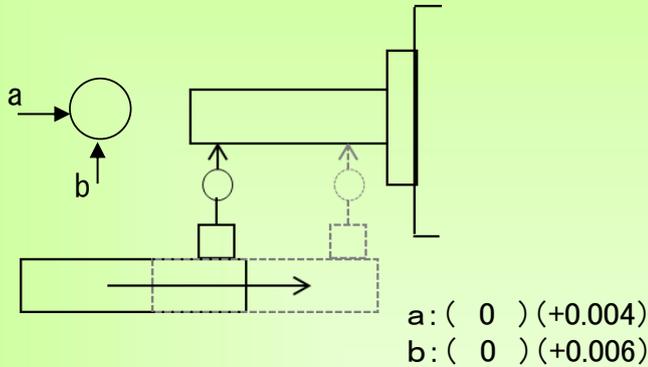

主軸振れ



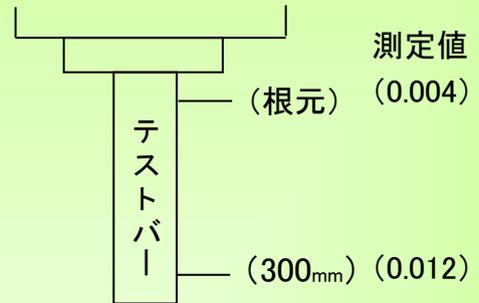


直角度

【XY】 測定値 (0.008)

【ZY】 測定値 (0.006)


【ZX】 測定値 (0.018)

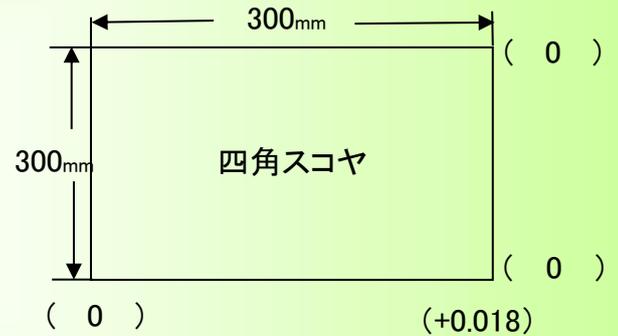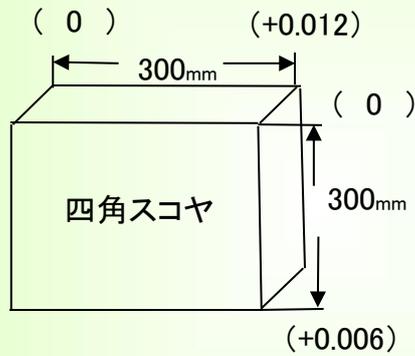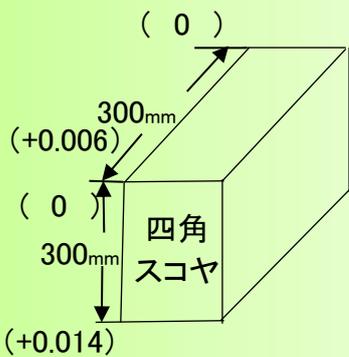

上面精度

テーブルサイズ : 400角

()パレット1
[]パレット2

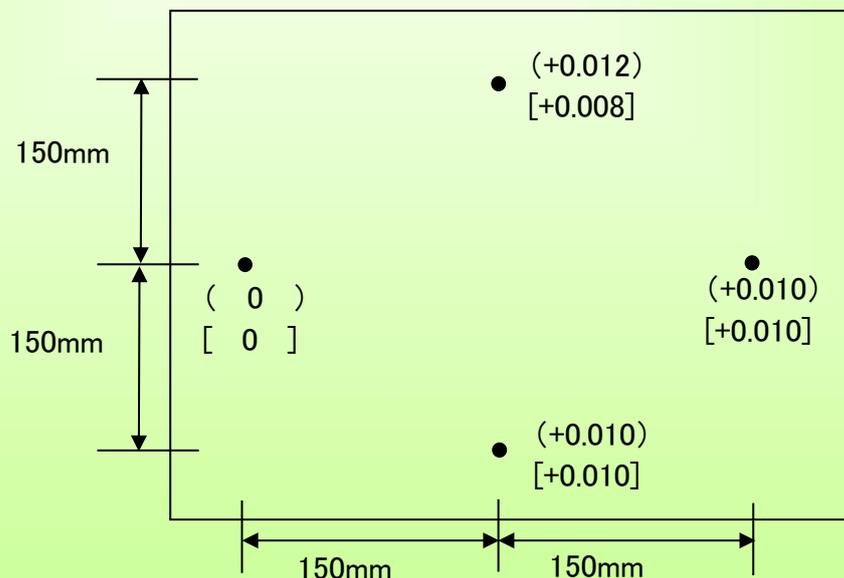

主軸側

2021/11/9